



ACCU-CHEK® Compact Plus

APARELHO DE GLICEMIA


Guia de Consulta
Rápida

⚠ Este Guia de Consulta Rápida não substitui o Manual do utilizador do aparelho Accu-Chek Compact Plus. Leia por favor os avisos de segurança contidos no manual.

1. Colocação ou substituição do rolo de tiras teste

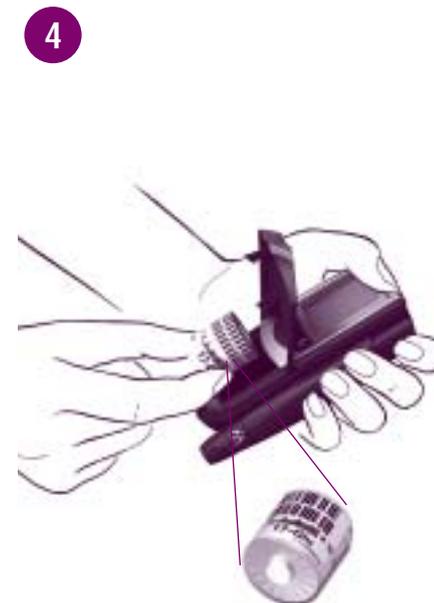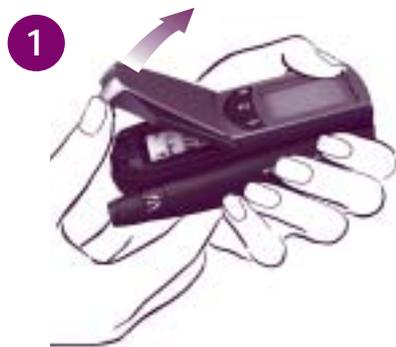

2. Preparação do dispositivo de punção capilar

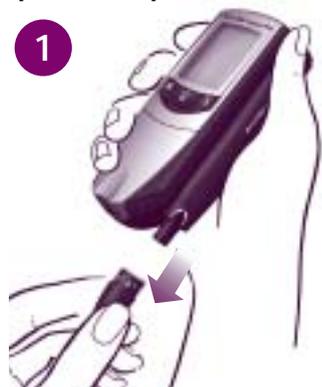

ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of a Member of the Roche Group.

 Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim
Germany
www.accu-chek.com

0 457 312 9001 (01) 01/05

3. Teste da glicemia

